

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy siêu âm tổng quát và đèn mổ treo trần của bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Ông Hoàng Đức Quảng - nhân viên phòng vật tư thiết bị y tế

Số điện thoại: 0779256678. Mail: Hoangducquang.YB@Gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai

Hoặc qua mail: Hoangducquang.YB@Gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 12 tháng 8 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 22 tháng 8 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo)


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 3 năm 2025

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi nhận được đầy đủ chứng từ theo quy định của pháp luật

5. Các thông tin khác (nếu có):

Nghĩa Lộ, Ngày 12 Tháng 8 năm 2025

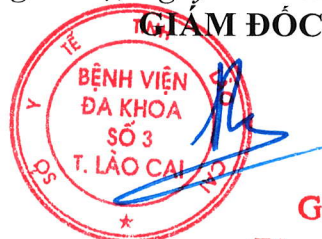

GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Tôn

DANH MỤC

(Kèm theo thư mời báo giá ngày 12/8/2025 của bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai)

STT	Nội dung mua sắm	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy siêu âm tổng quát (Máy siêu âm xách tay)	I. Cấu hình: - Máy chính: 01 chiếc - Đầu dò convex: 01 chiếc - Đầu dò linear: 01 chiếc - Gel siêu âm: 01 lọ - Vali đựng máy: 01 chiếc - Cáp nguồn: 01 chiếc - Tài liệu tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ II. Thông số kỹ thuật: - Màn hình: LCD 12,1 inch với góc điều chỉnh từ 0 độ – 30 độ - Sản xuất từ 2024 trở về sau - Đầu dò Convex tần số 3,5MHz, Dải tần số 2,5. 3,5. 4,5. 5 MHz, chiều rộng 60mm - Đầu dò Linear, tần số 7,5MHz, Dải tần số 5,3. 6,5. 7,5. 10 MHz, chiều dài 40mm - Đạt tiêu chuẩn Iso 13485	Máy	1
2	Đèn mổ treo trần	I. Cấu hình cung cấp: - Bộ cánh tay đỡ treo trần 2 nhánh: 01 bộ - Đầu đèn: 02 cái - Tay cầm có thể tiết trùng: 4 cái - Phụ kiện lắp đặt: 01 bộ - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ II. Thông số kỹ thuật: - Cường độ ánh sáng tại khoảng cách 1 m (Ec): ≥ 160.000 lux - Đường kính đầu đèn: ≥ 40 cm - Chỉ số hoàn màu (CRI): ≥ 96 Ra - Chỉ số hoàn màu (R9): ≥ 90 Ra - Đường kính trường sáng d10 khi cường độ chiếu sáng đạt 10% của Ec: ≥ 205 mm - Đường kính trường sáng có thể điều chỉnh: $\leq 140 - \geq 280$ mm - Độ sâu chiếu sáng IEC 60601-2-41 (L1+L2) ở mức 60%: ≥ 650 mm - Độ sâu chiếu sáng IEC 60601-2-41 (L1+L2) ở mức 20%: ≥ 1150 mm - Tỷ lệ giữa năng lượng bức xạ Ee và cường độ chiếu sáng Ec: 3,67 ($\pm 5\%$) - Tuổi thọ trung bình của đèn LED: ≥ 60.000 giờ - Điều khiển cường độ chiếu sáng: 20 - 100 %	Cái	1

STT	Nội dung mua sắm	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Hấp thụ điện năng: 52 W - 60 VA ($\pm 10\%$) - Sản xuất từ 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn Iso: 13485		
	Tổng 2 mặt hàng			

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Tôn